

DIACOM-IONISER-UNO (PPM METER)



*Генератор коллоидных ионов
серебра*

*Diacom-IOniser-UNO
PPM METER*

*и польза воды заряженной
частицами серебра*




АППАРАТ DIACOM-IONISER-UNO (PPM METER)

Вода наделена живительной силой – это неоспоримый факт, ведь и организм человека состоит в среднем на 65% из воды. Без нее невозможно представить существование ни одного живого организма. Из-за нехватки этого химического соединения нарушаются все биохимические процессы.



Польза воды для здоровья очевидна. Являясь активным участником биологических процессов, вода очищает наше тело как снаружи, так и изнутри, улучшает самочувствие и омолаживает организм на клеточном уровне. К сожалению, большинство из нас не уделяют должного внимания питьевым вопросам, употребляя не более трети суточной нормы H₂O в день, причем это количество приходится на воду, поступающую в наш организм с фруктами, овощами, другими продуктами или напитками (газированными, чаем, кофе и пр.).

Чистой же питьевой воды организм не получает, что приводит к дефициту живительной влаги и обезвоживанию, а это чревато серьезными последствиями. Вред, который наносит обезвоживание, просто огромен. Дело в том, что организм, пытаясь своими силами компенсировать недостаток жидкости, постепенно забирает её из клеток и крови. В свою очередь нарушается функционирование жизненно важных органов – мозга, сердца, легких, печени и др. и даже суставов.

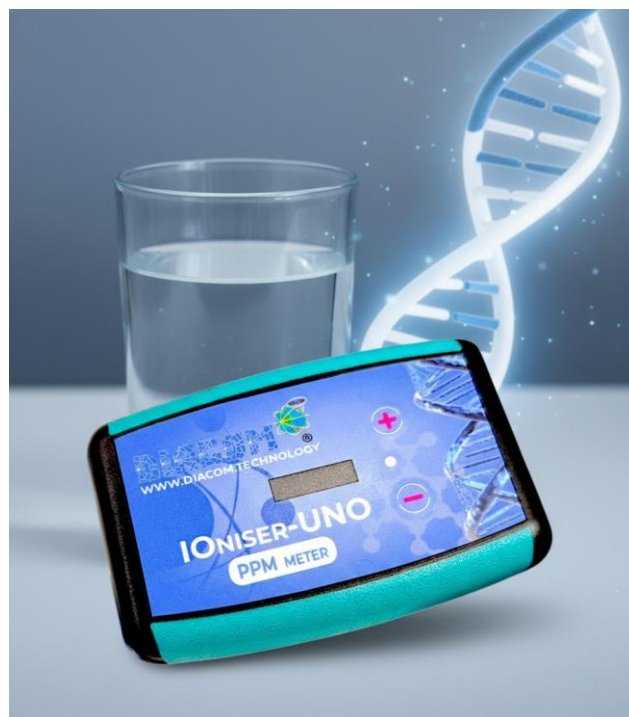

Кожа становится сухой и дряблой, появляются чувство усталости, головные боли, человек становится рассеянным, снижается иммунитет... А ведь достаточно выпивать всего стакан чистой воды раз в час-два. И многих проблем со здоровьем можно избежать! Соблюдение питьевого режима – залог хорошего самочувствия и отличная профилактика многих заболеваний.



Максимальной пользой обладает стакан воды, выпитой натощак. Потерявший за время сна влагу, организм нуждается в её восстановлении. Пить воду натощак – одна из лучших привычек.



Только не забудьте об очищении воды. Вред водопроводной воды не оставляет поводов для сомнений. Кипяченая вода, которую привыкли пить многие из нас, для оздоровления также не подойдет. Не зря она называется «мертвой». Серьезный вред она, конечно, не нанесет, но такая вода лишена полезных веществ и кислорода, а значит эффект от её употребления будет минимальный.

Кипяченая вода может быть использована в одном случае, если кроме сырой воды сомнительного качества других источников жидкости поблизости нет. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдавать фильтрованной воде, и воде, заряженной коллоидным серебром.



Коллоидное серебро – это отличная альтернатива антибиотикам. Ни одна известная болезнетворная бактерия не выживает в присутствии даже минимального количества серебра, тем более в коллоидном состоянии. Лечебные свойства коллоидного серебра известны уже давно.



Коллоидное серебро представляет собой коллоидный раствор сверхмалых частиц серебра, находящихся во взвешенном состоянии. Хотя механизм бактерицидного действия серебра пока детально неизвестен, полагают, что ионы серебра угнетают специфический фермент, который участвует в процессах метаболизма многих видов бактерий, вирусов и грибков. Получить коллоидное серебро в домашних условиях можно с помощью генератора коллоидных ионов серебра Diacom Solo-IOniser

Аппарат IOniser – UNO (PPM METER):
Универсальный генератор для самостоятельного приготовления ионных и коллоидных растворов

Генератор **IOniser-UNO** представляет собой сертифицированное устройство, предназначенное для приготовления ионно-коллоидных растворов методом электролитического синтеза. Аппарат прошел полный цикл испытаний, включая проверку на электромагнитную совместимость, безопасность для здоровья людей и животных, а также на экологическую безвредность.



- **Электромагнитная совместимость:**

Гарантирует безопасное использование вблизи других электронных устройств.

- **Экологическая безопасность:**

Не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

- **Безопасность для здоровья:**

Безопасен для использования людьми и животными.



IONiser – UNO (PPM METER) не является медицинским прибором. Это устройство для генерации коллоидных растворов и растворов ионов металлов в домашних условиях.

Внешний вид и функционал:

Аппарат **IONiser – UNO PPM METER** имеет компактный корпус, оснащенный светодиодной панелью. Эта панель отображает концентрацию ионов в растворе, выраженную в PPM (частях на миллион). Для удобства зарядки устройство имеет разъем для подключения USB-кабеля.

В нижней части имеется два разъема для установки требуемых типов электродов (серебро, золото, цинк, медь и т.д.). Светодиодная панель индицирует работу прибора, а также смену полярности. Аппарат выполнен в корпусе размером 117х78х25 мм.



В комплектацию аппарата входит, помимо основного блока, кабель питания и два серебряных электрода из серебра 999 пробы прошедших соответствующую сертификацию. Аппарат поставляется в специализированном алюминиевом

чемоданчике. Внутри основного блока расположены: радиоэлектронная плата с компонентами - включающая схему контроля питания от внешнего источника, схему управления светодиодом и информационным дисплеем, а также схему для генерации электромагнитных волн.



Аппарат генерирует специальные частоты, параллельно меняя полярность на электродах, что позволяет достичь насыщения дистиллированной воды коллоидами серебра (золота, меди, цинка и т.д.) в зависимости от установленных, в соответствующие разъемы аппарата, металлов.

Лицевая панель:	Информационный дисплей – отображение текущих параметров работы Светодиодный индикатор – визуализация работы устройства и смены полярности Кнопки управления – интуитивное управление режимами работы
Разъемы:	USB-C порт – для подключения внешнего источника питания Два электродных разъема – для установки электродов различных металлов
Комплектация поставки:	Основной блок аппарата Кабель питания с USB-C разъемом Два серебряных электрода из серебра 999 пробы (сертифицированные) Специализированный алюминиевый кейс для хранения и транспортировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА:

Внутренняя конструкция:

Внутри корпуса расположена радиоэлектронная плата, включающая следующие функциональные блоки:

1. Схема контроля питания: • Источник питания – внешний блок; • Напряжение питания – 5 V; • Потребление тока – до 300 mA.	Стабилизация напряжения от внешнего источника Защита от перегрузок и коротких замыканий Контроль параметров входного питания
2. Схема управления индикацией:	Управление информационным дисплеем Контроль светодиодного индикатора Обработка сигналов с кнопок управления
3. Генераторная схема:	Генерация специальных частот для процесса ионизации Управление полярностью на электродах Контроль параметров электромагнитного воздействия

Коллоидное серебро, получаемое с помощью генератора коллоидных ионов **Diacom SOLO-IONiser-UNO** – это чистая, абсолютно природная субстанция, состоящая из чистой воды и субмикроскопических частиц минерального серебра (ионов серебра Ag^+).

Работой генератора коллоидных ионов серебра управляет цифровой микропроцессор, который в зависимости от назначения и объема раствора устанавливает определенные параметры тока на электродах и время работы устройства.

По химическому составу коллоидное серебро это нитрат серебра. Оно производится без каких-либо химических процессов, с использованием электромагнитного заряда, который суспензирует частицы серебра в воде с образованием раствора. В таком растворе содержится максимальное количество частиц серебра минимального размера. Коллоидный раствор серебра содержит частицы самой высокой пробы от 0,005 до 0,015 микрон. Изготовленные строго в соответствии с технологией, коллоидные «системы» не требуют дополнительных химических ингредиентов


Основоположником научного изучения механизма действия серебра на микробную клетку считают швейцарского ботаника Карла Негели. В конце XIX столетия он установил, что взаимодействие ионов серебра с клетками микроорганизмов вызывает их гибель.

Появились исследования фармакологических свойств серебросодержащих препаратов, использование их в клиниках стало повсеместным. Как показали



эксперименты, на серебряной пластинке дифтерийная палочка погибает через три дня, стафилококк — через два, а тифозная палочка — через 18 часов.

Эффект уничтожения бактерий препаратами серебра в 1750 раз сильнее карболовой кислоты. Ионы серебра препятствуют размножению болезнетворных бактерий, вирусов, грибов. При этом спектр действия коллоидного серебра распространяется на 650 видов бактерий (для сравнения — спектр действия любого антибиотика 5-10 видов бактерий). Немногие знают, что по эффективности уничтожения бактерий серебро намного активнее хлора, не дает токсических соединений с примесями воды и не имеет специфического запаха.

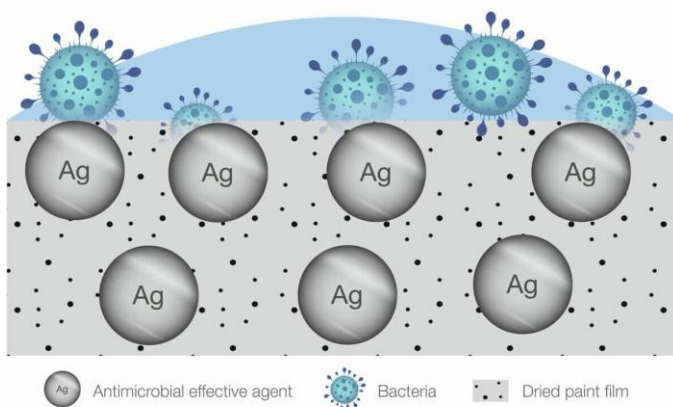

В организме человека постоянно происходит обмен веществ. При этом общее количество воды, поступающей за день в организм, должно покрывать ее потери.

Человек, который пьет недостаточно воды, позволяет отходам скапливаться в клетках, тем самым ускоряя появление у себя различных болезней.

Наиболее эффективна для этих целей серебряная вода, которая, к тому же, способствует уничтожению патогенных бактерий в кишечнике, не влияя при этом на полезную микрофлору. Если этого не происходит, пищеварительная система поглощает токсичные вещества из кишечника.


Серебряная вода может быть использована для обеззараживания и консервирования питьевых и минеральных вод, фруктовых и овощных соков, так как она предотвращает процессы гниения и брожения, обезвреживая микроорганизмы.



PPM (parts per million) воды в контексте генератора коллоидных ионов серебра **IONiser – UNO (PPM METER)** обозначает концентрацию ионов серебра, содержащихся в растворе, произведенном этим аппаратом. Это показатель количества ионов серебра на миллион частей воды, что позволяет точно регулировать и контролировать дозировку для различных целей применения. В контексте коллоидного серебра, ppm указывает на концентрацию серебра в воде. Например, 10 ppm означает, что в одном миллионе частей воды содержится 10 частей серебра. Чем выше значение ppm, тем более концентрированный раствор.



PPM в биорезонансном приборе, таком как генератор коллоидного серебра **IONiser – UNO (PPM METER)**, является ключевым показателем, который помогает пользователям правильно использовать растворы для достижения максимальной эффективности и безопасности.

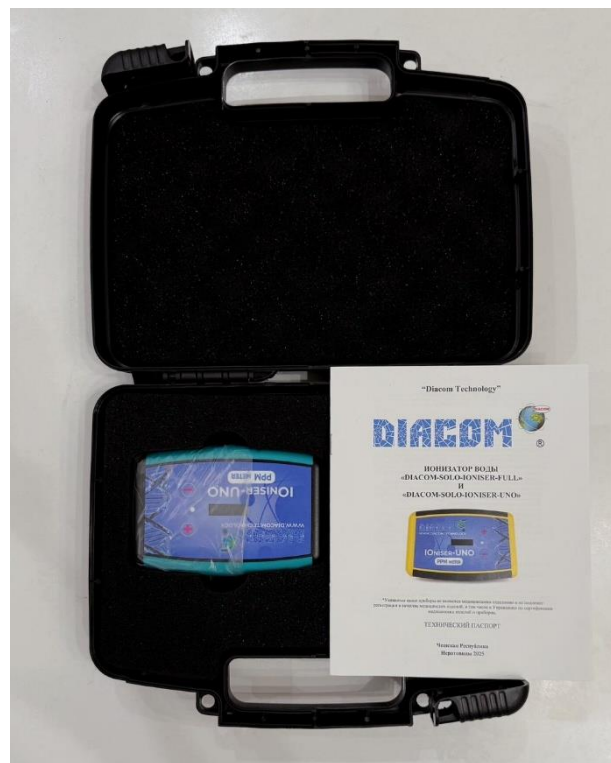

Ниже представлены рекомендации по использованию растворов с разной концентрацией (ppm):

10 PPM — Внутреннее применение

Способы применения: Прием внутрь в виде раствора.

Показания: профилактика различных состояний мочевыводящих путей (цистит, уретрит), кандидоз, диарея, укрепление иммунитета, грипп и простуда.

- **Цистит:** уменьшение воспаления и профилактика бактериального роста в мочевыводящих путях.
- **Уретрит:** помогает облегчить симптомы воспаления.
- **Кандидоз (молочница):** может уменьшать симптомы, вызванные грибковыми инфекциями.
- **Диарея:** может помочь в борьбе с патогенными микроорганизмами.
- Может применяться **для укрепления иммунитета** и общего оздоровления организма
- **Грипп и простуда:** использование для поддержки иммунной системы и сокращения продолжительности симптомов.
- **Пиелонефрит:** для уменьшения воспаления и поддержки лечения инфекций почек.
- **Гастрит:** может помочь в снижении воспаления слизистой оболочки желудка.
- **Дисбактериоз:** для восстановления нормальной микрофлоры кишечника.
- **Хронические респираторные заболевания:** для поддержки иммунной системы при бронхите или астме.
- **Инфекции верхних дыхательных путей:** для помощи в борьбе с вирусами и бактериями, вызывающими заболевания.

- **Аллергические реакции:** для снижения воспалительных процессов и облегчения симптомов.
- **Гепатит:** для поддержки функции печени и уменьшения воспаления.
- **Аутоиммунные заболевания:** для поддержки иммунной системы и снижения воспалительных процессов.
- **Профилактика инфекций:** в период эпидемий гриппа и простуды для укрепления иммунной системы.
- **Синдром раздраженного кишечника (СРК):** для облегчения симптомов и поддержания здоровья кишечника.
- **Кишечные инфекции:** для поддержки лечения инфекций, вызванных бактериями или вирусами.
- **Хронический холецистит:** для уменьшения воспаления желчного пузыря и поддержки функции печени.
- **Панкреатит:** для поддержки работы поджелудочной железы и уменьшения воспалительных процессов.
- **Токсоплазмоз:** для поддержки иммунной системы и борьбы с паразитарной инфекцией.
- **Микоплазменные инфекции:** для поддержки лечения инфекций, вызванных микоплазмами.
- **Бактериальные инфекции:** для борьбы с различными бактериальными инфекциями, включая стрептококковые и стафилококковые.
- **Гриппоподобные заболевания:** для облегчения симптомов и поддержки иммунной системы.
- **Инфекционные заболевания мочеполовой системы:** для лечения инфекций, таких как пиелонефрит или простатит.
- **Системные инфекции:** в качестве вспомогательной терапии при системных инфекциях.
- **Профилактика послеоперационных инфекций:** для снижения риска инфекций после хирургических вмешательств.

20 PPM — Наружное применение

Способы применения: Промывания и орошения (например, в виде раствора для полоскания, орошения кожи).

Показания: Профилактика кожных воспалений, вагинальных инфекций, акне, неглубоких ожогов, дезинфекция ран, воспалительные процессы в полости рта, носа или горла.

- **Наружное применение:** полезно при кожных воспалениях, укусах насекомых — может облегчить зуд и уменьшить воспаление.
- **Вагинальные орошения:** рекомендуется для облегчения симптомов во время вагинальных инфекций.
- **При акне:** может помочь в снижении воспаления и очищении пор.
- **При ожогах (неглубоких):** способствует заживлению и снижению риска инфекций.

Используется для дезинфекции ран, слизистых оболочек при гинекологических процедурах

- Эффективен при лечении **воспалительных процессов в полости рта, носа или горла**
- Применяется **для гигиенических процедур у животных**
- **Синусит:** для промывания носовых пазух с целью уменьшения воспаления и очищения от слизи.
- **Тонзиллит:** для полоскания горла при воспалении миндалин, что может помочь в облегчении боли и уменьшении воспаления.
- **Гингивит:** для орошения десен с целью уменьшения воспаления и профилактики заболеваний полости рта.
- **Цистит:** для промывания мочевыводящих путей с целью уменьшения воспаления и предотвращения инфекций.

- **Конъюнктивит:** для промывания глаз при воспалительных процессах или аллергических реакциях.
- **Уретрит:** для уменьшения симптомов воспаления при инфекциях мочевыводящих путей.
- **Кожные инфекции:** для орошения пораженных участков кожи при поверхностных инфекциях.
- **Грибковые инфекции:** для вагинальных орошений при кандидозе или других грибковых инфекциях.
- **Ожоги:** для промывания и дезинфекции неглубоких ожогов с целью предотвращения инфекций.
- **Профилактика инфекций после хирургических вмешательств:** для орошения раневых поверхностей и снижения риска инфекций.
- **Фарингит:** для полоскания горла при воспалении глотки, чтобы уменьшить боль и воспаление.
- **Отит:** для орошения уха при воспалительных процессах, чтобы облегчить симптомы.
- **Псориаз:** для промывания и орошения пораженных участков кожи, чтобы уменьшить воспаление и зуд.
- **Герпес:** для орошения пораженных участков кожи или слизистых оболочек при обострении.
- **Аллергический ринит:** для промывания носа с целью уменьшения симптомов аллергии и очищения от аллергенов.
- **Дерматит:** для орошения пораженных участков кожи с целью уменьшения воспаления и зуда.
- **Вульвовагинит:** для орошений при воспалении наружных половых органов.
- **Периодонтит:** для орошения десен и зубов при воспалении тканей, окружающих зубы.
- **Кожные абсцессы:** для промывания и дезинфекции области с гнойными образованиями.
- **Наружные инфекции мочевыводящих путей:** для орошения при инфекциях, таких как вульвовагинит или уретрит.

40 PPM — Наружное применение

Способы применения: Применение только наружно (например, в виде спрея или компресса).

Показания: Обработка кожных поражений (экзема, дерматит), грибковые инфекции кожи и ногтей, профилактика инфекций при порезах и ссадинах, косметические процедуры, аллергические реакции, укусы насекомых, солнечные ожоги.

- **Обработка кожных поражений:** экзема, дерматит — может снизить воспаление и ускорить заживление.
- **Устранение грибковых инфекций кожи:** использование в качестве противогрибкового средства.
- **Применение в косметических процедурах:** рекомендуется для очищения и дезинфекции кожи перед нанесением косметики.
- **При грибковых инфекциях ногтей:** возможно использование для обработки пораженных участков.
- **Профилактика инфекций при порезах и ссадинах:** применение на ранних стадиях для предотвращения бактериального инфицирования.
- **Кожные аллергические реакции:** для уменьшения зуда и воспаления при аллергическом дерматите.
- **Укусы насекомых:** для облегчения зуда и уменьшения отека после укусов.
- **Солнечные ожоги:** для охлаждения и заживления кожи после солнечных ожогов.
- **Псориаз:** для уменьшения воспаления и зуда, а также для улучшения состояния кожи.
- **Герпес:** для уменьшения высыпаний и ускорения заживления при герпетических инфекциях кожи.

- **Фурункулы и карбункулы:** для обработки воспаленных участков и снижения риска бактериальной инфекции.
- **Трещины на коже:** для ускорения заживления и предотвращения инфекций в местах трещин.
- **Инфекции кожи:** для лечения поверхностных бактериальных инфекций, таких как импетиго.
- **Профилактика инфекций после татуировок или пирсинга:** для дезинфекции и ухода за местами нанесения.
- **Воспалительные заболевания кожи:** такие как розацеа или акне, для уменьшения воспаления и улучшения состояния кожи.
- **Грибковые инфекции волосистой части головы:** для обработки пораженных участков при дерматомикозах.
- **Микозы стоп:** для лечения грибковых инфекций между пальцами ног и на подошвах.
- **Кожные инфекции после хирургических вмешательств:** для обработки швов и предотвращения инфекций.
- **Кожные проявления ветряной оспы:** для облегчения зуда и ускорения заживления высыпаний.
- **Лишай:** для лечения кожных поражений, вызванных грибами.
- **Себорейный дерматит:** для уменьшения воспаления и улучшения состояния кожи головы и лица.
- **Контактный дерматит:** для уменьшения воспалительных реакций на раздражители или аллергены.
- **Кожные бородавки:** для обработки и дезинфекции пораженных участков.
- **Профилактика инфекций при уходе за ранами:** для обработки ран и ссадин в домашних условиях.
- **Постакне:** для улучшения состояния кожи и уменьшения следов после акне.

100 PPM — Наружное применение

Способы применения: Применение только наружно (например, в виде раствора для обработки ран).

Показания: Сепсис, глубокие раны и ожоги, инфекции дыхательных путей, гнойные инфекции кожи, инфекции послеоперационных швов, системные грибковые инфекции, тяжелые формы акне, инфекции ушей, хронические раны.

обычно используется в более серьезных случаях, требующих высокой антимикробной активности.

- **Сепсис:** для поддержания антимикробной терапии в условиях системного воспалительного ответа.
- **Обработка глубоких ран и ожогов:** для дезинфекции и предотвращения инфекций в сложных случаях.
- **Гнойные инфекции кожи:** для обработки гнойников и абсцессов.
- **Системные грибковые инфекции:** для поддержки лечения при тяжелых грибковых инфекциях, когда требуется наружное применение.
- **Инфекции полости рта и горла:** для лечения тяжелых форм стоматита или фарингита, например, с помощью полоскания.
- **Тяжелые формы акне:** для лечения воспалительных процессов и предотвращения бактериальных инфекций.
- **Инфекции ушей:** для обработки наружного уха при наличии гнойного выделения.
- **Хронические раны:** для обработки и дезинфекции хронических язв и трофических язв.
- **Кожные инфекции, вызванные стафилококками:** для лечения инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами.

- **Гингивит и пародонтит:** для наружного применения при воспалительных заболеваниях десен.
- **Глубокие раны и ожоги:** для дезинфекции и предотвращения инфекций в сложных случаях.
- **Инфекции дыхательных путей:** при пневмонии или бронхите для ингаляционного применения.
- **Инфекции мочевыводящих путей:** в более тяжелых случаях, когда требуется усиленная терапия.
- **Гнойные инфекции кожи:** для обработки гнойников и абсцессов.
- **Инфекции послеоперационных швов:** для предотвращения развития инфекций в послеоперационный период.
- **Системные грибковые инфекции:** для поддержки лечения при тяжелых грибковых инфекциях.
- **Инфекции полости рта и горла:** для лечения тяжелых форм стоматита или фарингита.
- **Тяжелые формы акне:** для лечения воспалительных процессов и предотвращения бактериальных инфекций.
- **Инфекции ушей:** для лечения отитов, особенно при наличии гнойного выделения.
- **Псориаз:** для уменьшения воспаления и предотвращения вторичных инфекций.
- **Хронические раны:** для обработки и дезинфекции хронических язв и трофических язв.
- **Кожные инфекции, вызванные стафилококками:** для лечения инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами.
- **Гингивит и пародонтит:** для дезинфекции и лечения воспалительных заболеваний десен.
- **Травмы, связанные с загрязнением:** для профилактики инфекций в случае загрязнения раны.
- **Инфекции, вызванные вирусами:** для поддержки лечения при вирусных инфекциях с высоким риском бактериальной суперинфекции.

- **Кандидоз кожи:** для лечения тяжелых форм грибковых инфекций кожи, особенно в складках.
- **Инфекции глаз:** для обработки конъюнктивита и других инфекционных состояний глаз.
- **Микозы полости рта:** для лечения тяжелых форм кандидоза и других грибковых инфекций слизистой оболочки рта.
- **Тяжелые формы дерматита:** для уменьшения воспаления и предотвращения вторичных инфекций.
- **Фурункулы и карбункулы:** для обработки глубоких гнойных воспалений кожи.
- **Респираторные инфекции:** для ингаляционного применения при тяжелых формах бронхита или пневмонии.
- **Системные инфекции:** для поддержки лечения при септическом шоке и других системных инфекциях.
- **Инфекции, связанные с катетерами:** для профилактики и лечения инфекций, возникающих из-за использования катетеров.
- **Гнойный синусит:** для промывания носовых пазух с целью уменьшения воспаления и дезинфекции.
- **Туберкулез кожи:** для лечения кожных проявлений туберкулеза.
- **Гнойные инфекции после хирургических вмешательств:** для дезинфекции раневых поверхностей и предотвращения инфекций.
- **Тяжелые формы экземы:** для уменьшения воспаления и предотвращения вторичных инфекций.
- **Травмы с высоким риском инфекции:** для обработки открытых переломов и других серьезных травм.
- **Постоперационные инфекции:** для профилактики и лечения инфекций в послеоперационный период.
- **Инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам штаммами:** для лечения инфекций, вызванных резистентными бактериями.

Обратите внимание: концентрации ppm должны использоваться строго по назначению и рекомендациям специалиста или инструкции производителя. Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом Диаком.

Принцип работы и технология Diacom IOniser – UNO PPM METER

Категория	Элемент/Параметр	Описание
Технология	Основная технология	Diacom-SOLO-IOniser-UNO использует передовую технологию электрохимической ионизации
Процесс: Этап 1	Установка электродов	В соответствующие разъемы устанавливаются электроды из требуемого металла
Процесс: Этап 2	Подготовка электродов	На этом этапе происходит подготовка прибора и электродов к процедуре электролиза. Сначала необходимо зафиксировать показания PPM (parts per million, или частей на миллион) в окружающем воздухе. Это делается путем помещения электродов в воздушную среду, свободную от примесей, которые могут повлиять на начальные измерения. До того, как аппарат стабилизируется и зафиксирует требуемые показатели PPM, электроды остаются в воздухе до следующего этапа. Только после этого прибор (с уже установленными электродами) будет погружен в дистиллированную воду.
Процесс: Этап 3	Погружение в дистиллированную воду	Электроды помещаются в емкость с водой
Процесс: Этап 4	Генерация специальных частот	Аппарат создает оптимальные электромагнитные условия
Процесс: Этап 5	Попеременная смена полярности	Автоматическое переключение полярности на электродах
Процесс: Этап 6	Контроль концентрации	Визуализация процесса на дисплее в PPM

Отображаемый параметр 1	Концентрация ионов	В частях на миллион (PPM)
Отображаемый параметр 2	Режим работы	Текущий статус процесса
Отображаемый параметр 3	Индикация полярности	Визуальное отображение смены полярности

Вода, заряженная ионами серебра при помощи прибора

DIACOM IOniser – UNO PPM METER:

Омолаживает кожу

ежедневное употребление питьевой воды, заряженной серебром, оказывает благотворное влияние на клетки кожи, предотвращая сухость, вода питает кожу изнутри.



Выводит токсины

нормальную деятельность почек обеспечивает правильное количество употребляемой человеком чистой воды. Как известно, почки являются естественным фильтром организма, а вода способствует выведению токсинов из системы ЖКТ, при этом в большей степени именно через почки.



Снижает риск инфаркта

пять стаканов серебряной воды, выпитой в течение дня, снижают риск возникновения сердечного приступа до 70%!



Естественная смазка для суставов

недостаток воды в организме способен вызвать мышечные спазмы. Вода является главным составляющим при образовании «смазочного» материала суставов и мышц. Для предотвращения мышечных спазмов при занятии спортом, рекомендуется употребление воды до и после тренировки.



Вода нужна ЖКТ

Вода просто необходима для нормального пищеварения. Вода не только предотвращает запоры, но и выводит «отходы» жизнедеятельности организма, кроме того, она участвует во всех химических процессах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), помогая доставлять питательные вещества и выводить отслужившие.



Снижает риск инфекционных заболеваний

Недостаток воды – прямой путь к обезвоживанию организма, а обезвоживание ведет к огромной «дыре» в иммунной системе. Снижение иммунитета ведет к тому, что мы заболеваем чаще, и переносим инфекционные заболевания тяжелее.



Регулирует температуру тела

Вода в качестве терморегулятора работает в нашем организме примерно, как система охлаждения в двигателе авто. Разгоряченный организм, например, после занятия спортом, требует восстановительной жидкости, чем и является питьевая вода с коллоидным серебром.



Сжигает жир

если учитывать энергозатратные процессы, коим является, к примеру, образование мышечной ткани. Чем больше сжигается калорий, тем больше требуется воды, ведь в процессе потоотделения на поверхность через потовые железы и поры выходит не только жидкость и токсины, но и жир.



Приобретайте наш генератор для приготовления ионных растворов

IONiser – UNO (PPM METER) и пейте воду на здоровье!

Наслаждайтесь чистой, насыщенной полезными ионами водой каждый день. Создавайте коллоидные растворы серебра, золота, меди и других металлов с максимальной точностью и безопасностью. Доверьте свое здоровье проверенной технологии от лидера в области ионных генераторов. Ваша команда Diacom Technology



Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
Certifikační orgán certifikující produkty / Product Certification Body
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)
Government Regulation 117/2016 Coll. and Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

Číslo:
Number **EMC-B-02087-20**

Držitel certifikátu: Owner of Certificate	Khachatur Mkrtchyan - Diacom Technology Jedová 189 277 11 Neratovice Česká republika – Czech Republic
Výrobce: Manufacturer	Khachatur Mkrtchyan - Diacom Technology Jedová 189 277 11 Neratovice Česká republika – Czech Republic
Výrobek: Product	Ionizátor vody Water ionizer
Typ/Model: Type/Model	DIACOM-SOLO-IONISER-FULL DIACOM-SOLO-IONISER-UNO
Aplikované normy: Standards applied	ČSN EN 55032 ed. 2:2017, ČSN EN 55024 ed. 2:2011
Podklad pro vydání certifikátu: Basis of Certificate issuance	Závěrečný protokol č. 31-10512/EZ ze dne 2020-11-27 Final Report 31-10512/EZ of 2020-11-27
Certifikát platí do: Certificate valid until	2025-11-29


Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (odpovídá příloze I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výše uvedeného výrobku a závěry přezkoušení jsou obsaženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-mentioned product is in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation conforms to Annex 2 of Government Regulation 117/2016 Coll. (corresponding to Annex I and Annex II of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned product and the conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified on Page 2.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.
Product certification scheme applied: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, Scheme 1a.

Brno, 2020-11-30

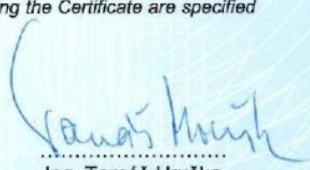


Ing. Tomáš Hruška
ředitel
Director

EMC-B-02087-20 Strana - Page 1/2

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



DIACOM-IONISER-UNO PPM METER

Генератор коллоидных ионов серебра и польза воды заряженной частицами серебра



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр)
Certifikační orgán certifikující produkty / Орган по сертификации продукции
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika / Чешская Республика

CERTIFIKÁT / СЕРТИФИКАТ

nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)
постановление Правительства № 117/2016, Сборник законодательных актов,
и Директива 2014/30/ЕС (Электромагнитная совместимость)

Číslo: **EMC-B-02088-20**
Номер

Držitel certifikátu: Владелец сертификата	Khachatur Mkrtchyan - Diacom Technology Jedová 189 277 11 Neratovice Česká republika – Чешская Республика
Výrobce: Изготовитель	DIACOM TECHNOLOGY INC s.r.o. Jedová 189 277 11 Neratovice Česká republika – Чешская Республика
Výrobek: Изделие	Ionizátor vody Ионизатор воды
Typ/Model: Тип/Модель	DIACOM-SOLO-IONISER-FULL DIACOM-SOLO-IONISER-UNO
Aplikované normy: Примененные стандарты	ČSN EN 55032 ed. 2:2017, ČSN EN 55024 ed. 2:2011
Podklad pro vydání certifikátu: Основание для выдачи сертификата	Závěrečný protokol č. 31-10513/EZ ze dne 2020-11-27 Заключительный протокол № 31-10513/EZ от 2020-11-27
Certifikát platí do: Сертификат действителен до:	2025-11-29


Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (odpovídá příloze I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výše uvedeného výrobku a závěry přezkoušení jsou obsaženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр.) potvrzuje, что вышеуказанное изделие соответствует основным техническим требованиям, установленным в приложении 1, и что техническая документация соответствует приложению 2 к постановлению Правительства № 117/2016 Сб. зак. (соответствует приложениям I и II к Директиве 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета). Результаты пересмотра технической документации, сведения, необходимые для идентификации вышеуказанного изделия, и результаты проверки содержатся в заключительном протоколе. Правила обращения с сертификатом приведены на странице 2.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.
Примененная схема сертификации: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, схема 1a.

Brno, 2020-11-30

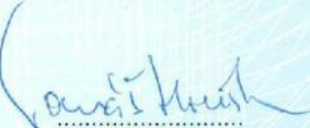


Ing. Tomáš Hruška
ředitel
директор

EMC-B-02088-20 Strana - Страница 1/2

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz





Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр)
Certifikační orgán certifikující produkty / Орган по сертификации продукции
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika / Чешская Республика

CERTIFIKÁT / СЕРТИФИКАТ

nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)
постановление Правительства № 117/2016, Сборник законодательных актов,
и Директива 2014/30/ЕС (Электромагнитная совместимость)

Číslo: **EMC-B-02087-20**
Номер

Držitel certifikátu: Владелец сертификата	Khachatur Mkrtchyan - Diacom Technology Jedová 189 277 11 Neratovice Česká republika – Чешская Республика
Výrobce: Изготовитель	Khachatur Mkrtchyan - Diacom Technology Jedová 189 277 11 Neratovice Česká republika – Чешская Республика
Výrobek: Изделие	Ionizátor vody Ионизатор воды
Typ/Model: Тип/Модель	DIACOM-SOLO-IONISER-FULL DIACOM-SOLO-IONISER-UNO
Aplikované normy: Примененные стандарты	ČSN EN 55032 ed. 2:2017, ČSN EN 55024 ed. 2:2011
Podklad pro vydání certifikátu: Основание для выдачи сертификата	Závěrečný protokol č. 31-10512/EZ ze dne 2020-11-27 Заключительный протокол № 31-10512/EZ от 2020-11-27
Certifikát platí do: Сертификат действителен до:	2025-11-29

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (odpovídá příloze I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výše uvedeného výrobku a závěry přezkoušení jsou obsaženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.


Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр.) подтверждает, что вышеуказанное изделие соответствует основным техническим требованиям, установленным в приложении 1, и что техническая документация соответствует приложению 2 к постановлению Правительства № 117/2016 Сб. зак. (соответствует приложениям I и II к Директиве 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета). Результаты пересмотра технической документации, сведения, необходимые для идентификации вышеуказанного изделия, и результаты проверки содержатся в заключительном протоколе. Правила обращения с сертификатом приведены на странице 2.

Použití certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.
Примененная схема сертификации: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, схема 1a.

Brno, 2020-11-30

EMC-B-02087-20 Strana - Страница 1/2

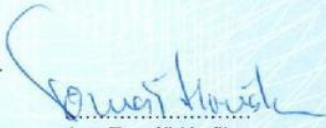


Ing. Tomáš Hruška
ředitel
директор

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz





Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise)
Certifikační orgán certifikující produkty / Product Certification Body
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic

CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

nařízení vlády č. 117/2016 Sb. a směrnice 2014/30/EU (Elektromagnetická kompatibilita)
Government Regulation 117/2016 Coll. and Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

Číslo:
Number **EMC-B-02088-20**

Držitel certifikátu:
Owner of Certificate
Khachatur Mkrtchyan - Diacom Technology
Jedová 189
277 11 Neratovice
Česká republika – Czech Republic

Výrobce:
Manufacturer
DIACOM TECHNOLOGY INC s.r.o.
Jedová 189
277 11 Neratovice
Česká republika – Czech Republic

Výrobek:
Product
Ionizátor vody
Water ionizer

Typ/Model:
Type/Model
DIACOM-SOLO-IONISER-FULL
DIACOM-SOLO-IONISER-UNO

Aplikované normy:
Standards applied
ČSN EN 55024 ed. 2:2011, ČSN EN 55032 ed. 2:2017

Podklad pro vydání certifikátu:
Basis of Certificate issuance
Závěrečný protokol č. 31-10513/EZ ze dne 2020-11-27
Final Report 31-10513/EZ of 2020-11-27

Certifikát platí do:
Certificate valid until
2025-11-29


Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že výše uvedený výrobek je ve shodě se základními technickými požadavky stanovenými v příloze 1 a že technická dokumentace odpovídá příloze 2 k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (odpovídá příloze I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU). Výsledky přezkoumání technické dokumentace, údaje potřebné k identifikaci výše uvedeného výrobku a závěry přezkoušení jsou obsaženy v závěrečném protokolu. Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Engineering Test Institute, Public Enterprise, hereby confirms that the above-mentioned product is in conformity with the essential technical requirements set forth in Annex 1 and that the technical documentation conforms to Annex 2 of Government Regulation 117/2016 Coll. (corresponding to Annex I and Annex II of Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council). The results of the technical documentation review, the data necessary for identification of the above-mentioned product and the conclusions drawn from testing are contained in the Final Report. The rules for using the Certificate are specified on Page 2.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.
Product certification scheme applied: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, Scheme 1a.

Brno, 2020-11-30

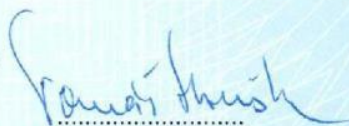


Ing. Tomáš Hruška
ředitel
Director

EMC-B-02088-20 Strana - Page 1/2

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



DIACOM-IONISER-UNO PPM METER

Генератор коллоидных ионов серебра и польза воды заряженной частицами серебра